


SÉRIE 528.85

FTfa-528.85 / v.2021/05

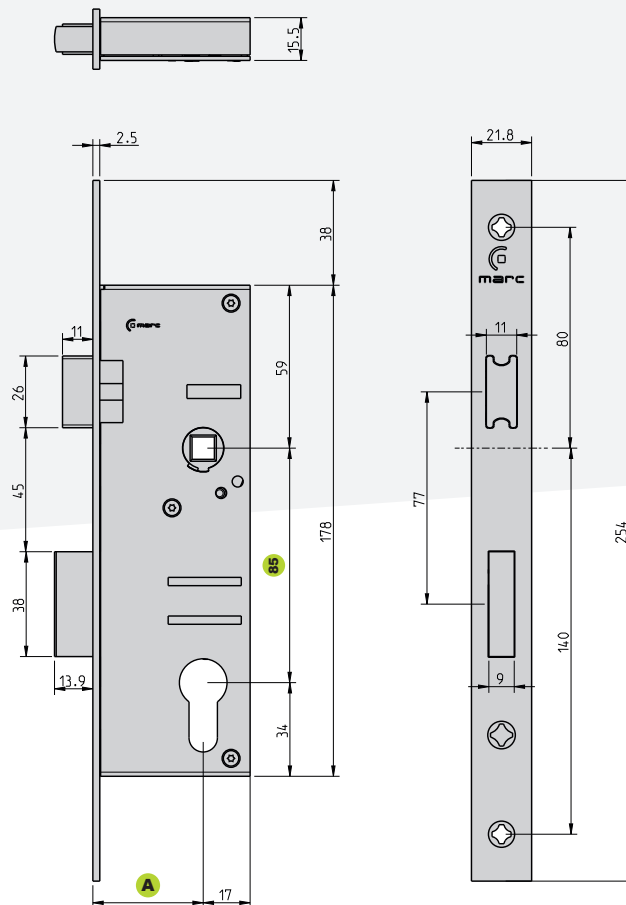

MAGNET

A				B	
25	30	35	40	85	8



PT CIL
EN PClock
FR Clé-1
DE PZ-Schloss

NORMA · STANDARD · NORME · NORM · EN12209



Testes realizados em nosso laboratório de fábrica - Tests made in our factory lab
Testes réalisés en notre laboratoire d'usine - Im Marques-Labor geprüft und bestätigt

